


10 Структура условного обозначения тензопреобразователей серии D

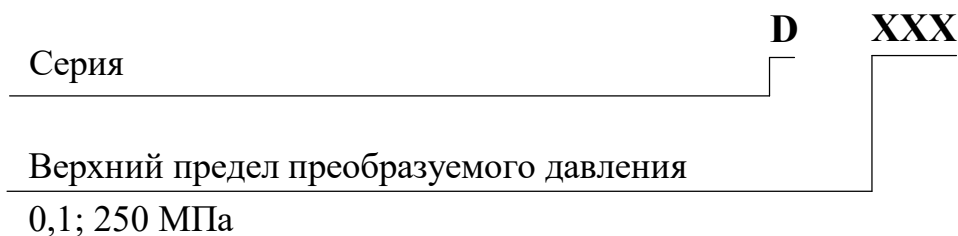

Пример записи обозначения при заказе

Тензопреобразователь серии D для преобразования избыточного давления от 0 до 0,1 МПа:

Тензопреобразователь D 0,1.

Примечание - Длина проводов (стандартная - 130 мм) может быть изменена при согласовании заказчика с предприятием-изготовителем, при этом в заказе должно стоять численное значение длины проводов, например:

Тензопреобразователь D 250-L200

11 Маркировка

Маркировка на корпусе тензопреобразователя должна содержать: условное обозначение тензопреобразователей и порядковый номер.

Дата					
Подпись					
Лист		Общество с ограниченной ответственностью "Микротензор"		Тензопреобразователи давления D 0,1 и D 250	
Изм.		РФ, 302040, г.Орел, ул. Ломоносова, 6, помещение 2 Тел.: +7(4862) 303-450, e-mail: ooo@microtensor.ru		M-424 2023	Лист 6 Листов 6